


EAV v2.0

szoftver verzió

újtonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

Betegek keresése.....	2
Csatolmány a betegkartonhoz.....	2
Mérések összehasonlítása.....	3
Fejpontok.....	4
Allergia teszt.....	4
Balancer.....	5
Étrend kiegészítők listája.....	6
Naptár.....	7
Egyéb apróbb újítások.....	8
 A bal és a jobb oldal.....	8
 Maximumértékek a táblázatban.....	9
 Saját logó a nyomtatási képen.....	10

EAV v2.0 - Megjelent a legújabb szoftver verzió az EAV végpontdiagnosztikai készülékekhez. A program mind a régi ún. mutatós műszeres, mind az új EAV Digital készülékhez használható. Az EAV v2.0-ás szoftver nem tartozéka a készüléknek, ez a kibővített funkcionális szoftver változat külön vásárolható meg (nem túl magas áron) és kizárólag arról az USB stickről futtatható, melyen szállítjuk.

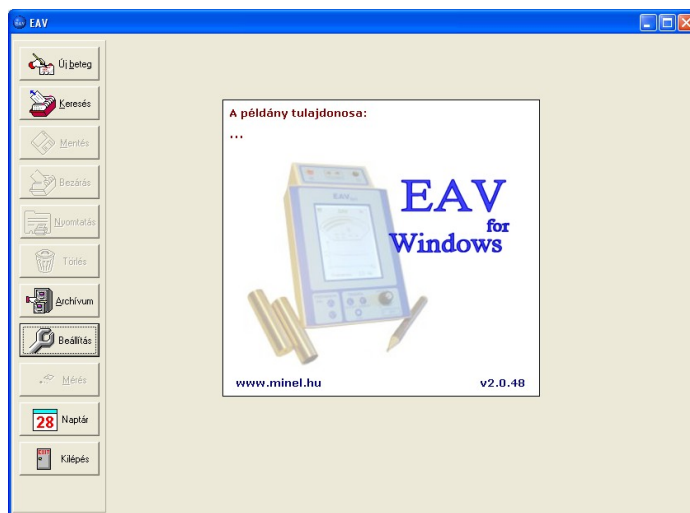


A program a régi verziótól eltérően egy pendrive-on kerül forgalomba. A program futtatásához mindig szükséges, hogy a pendrive be legyen dugva a számítógépbe.

Új szolgáltatások a programban:


Betegek keresése

A betegek kiválasztását segítő **kereső mező**. A Keresés gombot megnyomva megjelenik egy ablak a képernyő közepén, ami a betegnyilvántartóban található aktív betegek listáját tartalmazza. A lista felett látható a kereső mező. Ha ide beírunk egy nevet vagy egy név részletet, akkor a listában csak azok a nevek fognak szerepelni, amikben megtalálható a keresett név részlet.

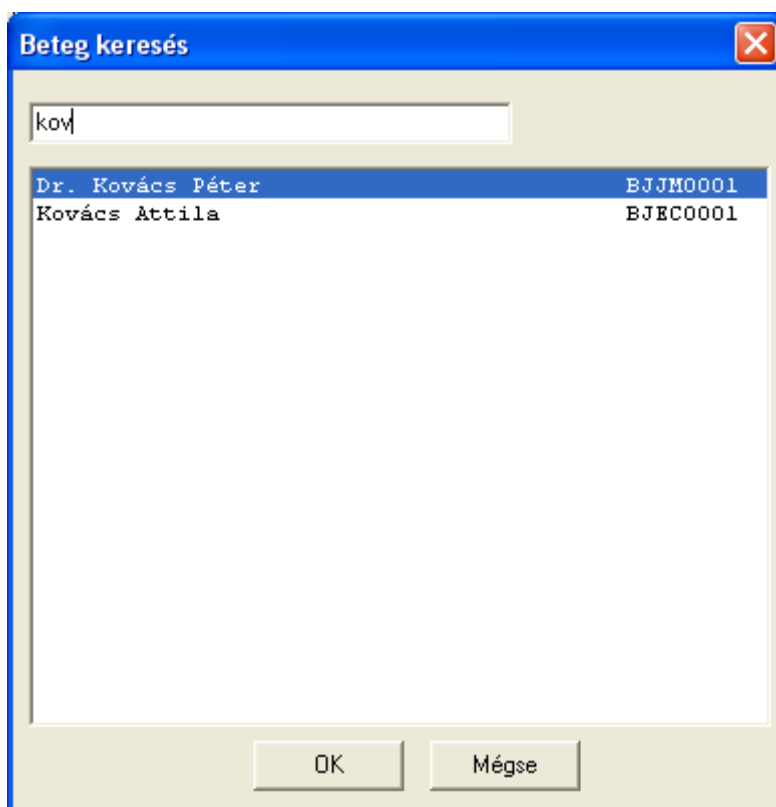

Csatolmány a betegkartonhoz


A Kartonozóban a felső választó fülek között szerepel egy új fül Csatolmányok felirattal. Ezt a fület választva tetszőleges fájlt (kép, Word dokumentum, PDF, Excel táblázat, stb.) hozzácsatolhat a megnyitott beteg kartonhoz. Ha a csatolt fájl kép akkor az rögtön meg is jelenik a képernyőn. Más típusú fájlok esetén a megnyitás gombbal indul el a szükséges alkalmazás.

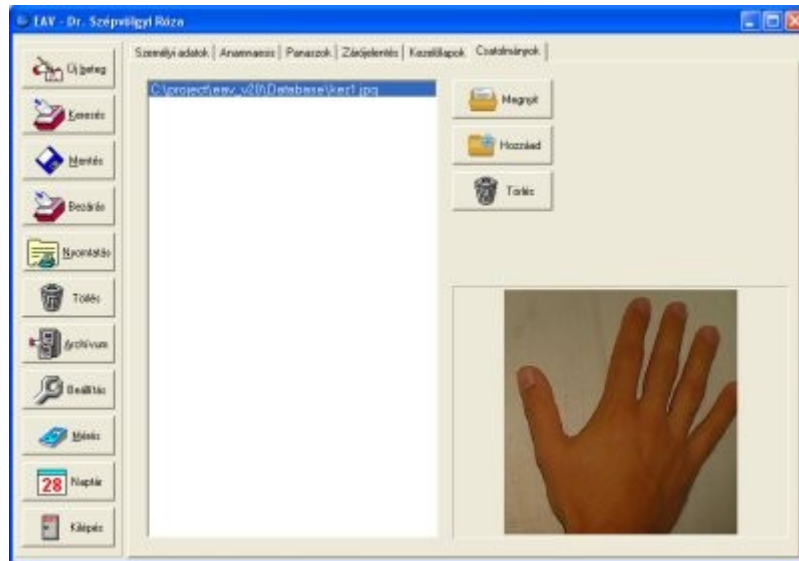

Ha a számítógéphez csatlakoztat egy webkamerát akkor könnyedén készíthet képet a betegről minden kezelés alkalmával. A képeket hozzácsatolva a kartonhoz végigkövethető a gyógyulás folyamata.

Mérések összehasonlítása

A Kartonozóban a Kezelőlapok oldalon található egy új gomb, az Összehasonlítás. Ezzel az elvégzett méréseket lehet összehasonlítani. A megjelenő ablakban grafikus összehasonlító diagrammot készíthet két mérés adataiból. A két mérés lehet két különböző időpontban elvégzett KMP mérés vagy lehet egy mérés esetén a jobb és baloldalon végzett mérések összehasonlítása.

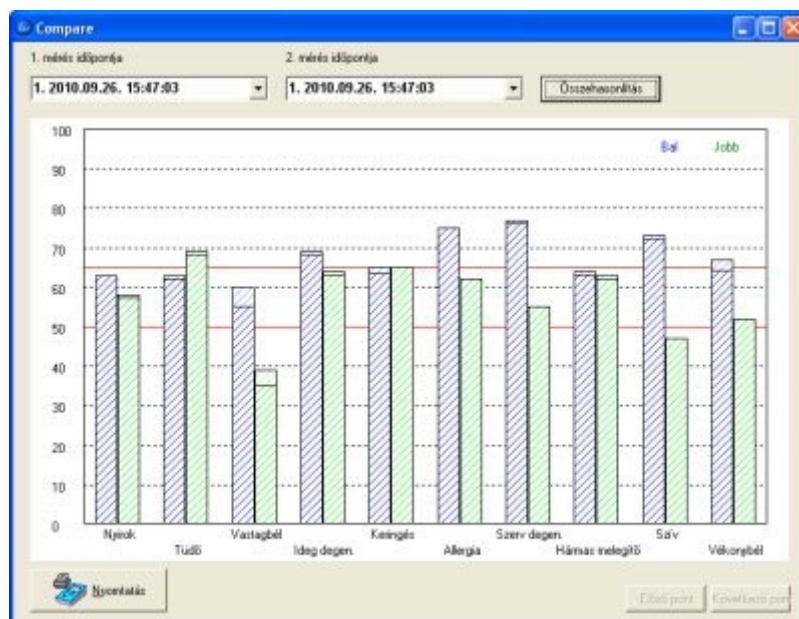


A felső mezőkben választhatja ki a két mérés dátumát. Ha ugyanazt a dátumot adja meg, akkor a jobb és baloldal összehasonlítását végzi a program.

Az összehasonlítás csak a kontroll mérőpont (KMP) mérésekre lehetséges.

Fejpontok


Fejpontok mérése. Egy teljesen új diagnosztikai lehetőséget nyújt a fejpontok mérése. A fején elhelyezett 38 pont mérését és a mért értékek kinyomtatását teszi lehetővé az új szoftver verzió.

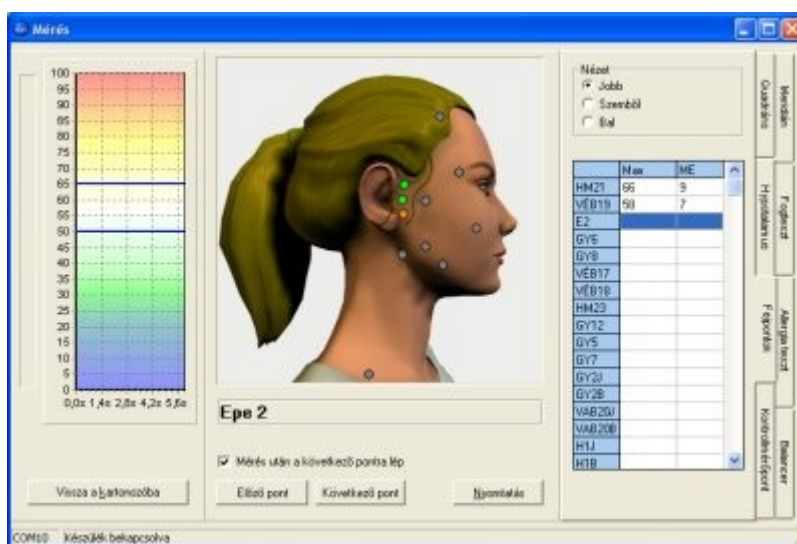

Allergia teszt

Külön fülön kapott helyet az allergia teszt amivel a szervezet számára allergén vagy toxikus anyagok kimérésére nyílik lehetőség. Külön fájlban megadható a vizsgált anyagok listája. Alapbeállításként az új szoftver egy 60 elemből álló anyaglistát tartalmaz. Ezt a listát a felhasználó szabadon bővítheti.

A mérés során a szoftver összehasonlítja, hogy az anyaggal mért érték mennyire tér el az anyag nélkül mért normál értéktől. Az eltérés alapján szövegesen tájékoztat, hogy az adott anyag milyen hatással van a szervezetre. Az eredménylista táblázatos formában kinyomtatható.

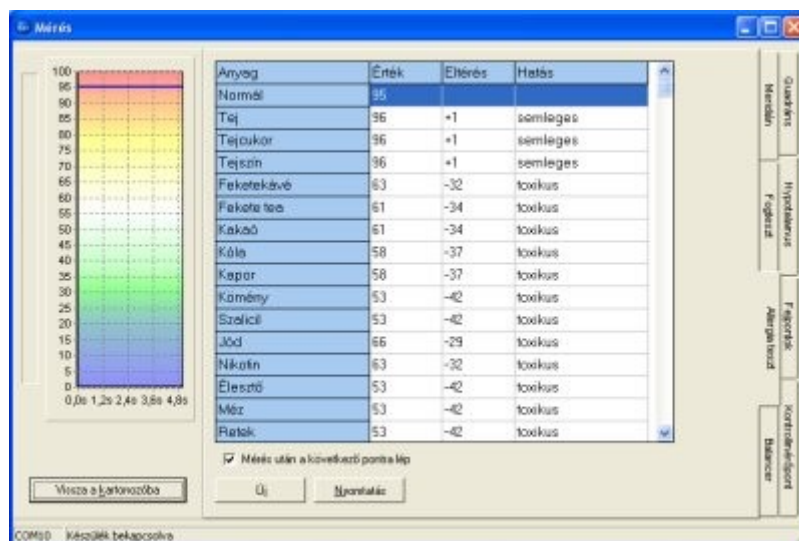


Először a Normál értéket kell megmérni vagyis egy anyag nélküli mérést. Ez lesz a referencia érték. A további méréseknél a táblázatban olvasható anyaggal kell visszamérni ugyanazt a pontot ahol a referencia mérést elvégezte. Ekkor beíródik a mérési érték, az eltérés a normál értéktől és egy szöveges értékelés, hogy ez az eltérés mire utal.

Balancer

A **Balancer** egy új funkció amivel a táplálék kiegészítők kiméréséhez nyújt támogatást az új szoftver. Nevét a kiegyensúlyozásról kapta mert a célja, hogy a megfelelő étrend kiegészítő megkeresésével a szervezet visszabilentse az egyensúlyi állapotába.

A szoftver tartalmaz egy listát az étrend kiegészítőkről. Ezt a listát a felhasználó szabadon módosíthatja, bővítheti, szerkesztheti. Mérés közben ebből a listából kell egy vagy több terméket kiválasztani.

A mérés során mindig látható a jobb és baloldalon anyaggal és anyag nélkül mért értékek is.

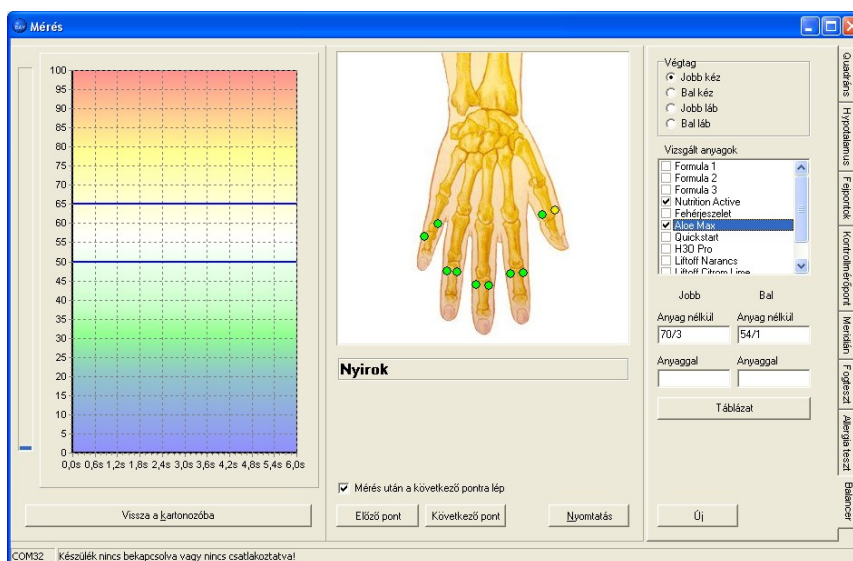

A mérés alatt a program egy táblázatot készít, ami tartalmazza az összes pontnál a normál értéket, az étrend kiegészítővel mért értéket, felsorolja a vizsgált étrend kiegészítők neveit, összehasonlítja a jobb és baloldal mérés eredményeit.

Jobb old.	Alap-ért.	Anyaggal	Anyagok	Különb.	Bal old.	Alap-ért.	Anyaggal	Anyagok
Nyrok	63/0	64/12	Multon Active	5	Nyrok	60/0	60/0	Multon Active
Tudli	63/1	67/15	H3D Pro. Thermoplastic Osana	6	Tudli	60/0	60/0	H3D Pro. Thermoplastic Osana
Vastagbél	68/5	65/13	H3D Pro	20	Vastagbél	39/4	64/12	H3D Pro
Ideg-degen.	68/1			5	Ideg-degen.	64/1		
Keringés	65/2			0	Keringés	65/8		
Állag	75/0			13	Állag	62/8		
Szerv-degen.	77/1			22	Szerv-degen.	55/8		
Hámas-szegítő	64/1			1	Hámas-szegítő	63/1		
Szív	73/1			26	Szív	47/8		
Vékonybél	67/3			15	Vékonybél	52/8		
Jobb old.	Alap-ért.	Anyaggal	Anyagok	Különb.	Bal old.	Alap-ért.	Anyaggal	Anyagok
Hormonterp.	60/2				Lito			
Máj	79/2				Máj			
Uréter-degeneráció	61/1				Uréter-degeneráció			
Építő	72/1				Építő			
Falkóvet-degen.	62/0				Kalciumvet-degen.			
Bél	68/0				Bél			
Zsír-degen.	78/0				Zsír-degen.			
Építőanyag	78/2				Építőanyag			
Vese	67/1				Vese			
Hővesz	63/3				Hővesz			

A mérést először a kontroll mérőpontok végigmérésével kell kezdeni. A program a kontroll mérőpont mérés eredményeit veszi alapértéknek.

Ezután lehet átváltani a Balancer oldalra. Az oldal megjelenése hasonló a KMP méréshez. Itt is kiválaszthatjuk a négy végtagot és a képen is ugyanazok a pontok jelennek meg, mint a KMP mérésnél.

Az ablak jobb oldalán látható egy kis lista a vizsgált étrend kiegészítőkről. Ezek közül kell kipipálni azokat amikkel a mérést végezzük. Egyszerre többet is ki lehet választani. Most ha elvégezzük a mérést, az eredmény bekerül a táblázatba az „Anyaggal” feliratú oszlopba. A kiválasztott anyagok neve pedig megjelenik az „Anyagok” oszlopban.

Így végigmérve újra az akupunktúrás pontokat a teljes táblázat kitöltésre kerül. A táblázatot ki lehet nyomtatni és exportálni. Az exportálás csv formátumban történik, ezt később Excel-lel be lehet olvasni.


Figyelem! Az EAV program nem menti a táblázat tartalmát a Kezelőlapokhoz!

Étrend kiegészítők listája

A Balancer a vizsgált anyagok neveit a balancer_hu.txt fájlból veszi. Ez egy szöveges fájl ami szabadon szerkeszthető. Lehet belőle törölni, vagy új anyagneveket hozzáadni igény szerint. A fájl a pendrive főkönyvtárában található.

Naptár


Beépített **Naptár** funkció. Megadható a kontroll vizsgálat dátuma. A program automatikusan figyeli a naptárban megadott dátumokat, figyelmezteti a felhasználót ha elérkezett a megadott időpont.

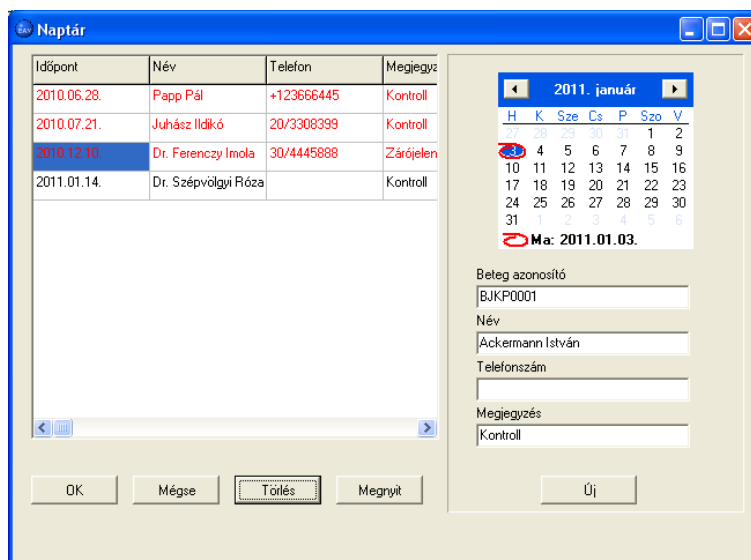

Az ablak a kartonozó Naptár feliratú gombjának megnyomására jelenik meg. A listában pirossal láthatók a mainál régebbi dátumok. A Törlés gombbal lehet törölni a lista kiválasztott sorát. A Megnyit gombbal automatikusan megnyitódik a kiválasztott sorhoz tartozó beteg kartonja.

A naptárba új sort felvenni az ablak jobb oldali mezőinek kitöltésével, a dátum kiválasztásával és az Új gomb megnyomásával lehet. Ha meg van nyitva beteg karton akkor a Beteg azonosító, Név, Telefonszám mezők automatikusan kitöltődnek.

Lehetőség van a naptár bejegyzések teljesen automatikus felvételére is. Ehhez a Beállítások ablakban a Naptár fülön be kell pipálni az „Új méréskor új naptárbejegyzés” sort és megadni, hogy a mérés időpontjához képest hány nappal későbbre állítsa a naptárbejegyzés időpontját.

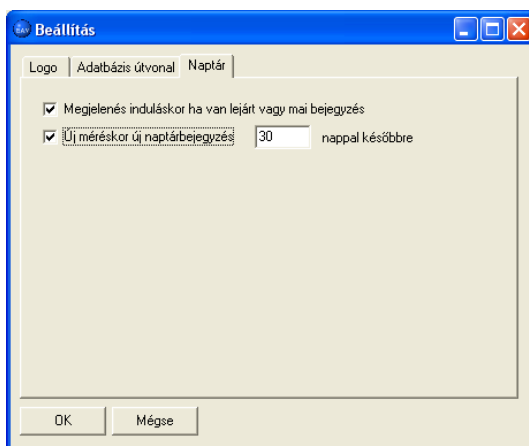

Így egy mérés elvégzése után automatikusan bekerül a beteg neve a naptárba. A naptárbejegyzéshez tartozó szöveg „Kontroll” lesz.

A Beállítások ablakban ki lehet még pipálni a „Megjelenés induláskor ha van lejárt vagy mai bejegyzés” sort. Ez azt jelenti, hogy az EAV program elindulásakor megnézi a program, hogy van-e a naptárban mai vagy régebbi bejegyzés és ha igen, akkor megjelenik a Naptár.

Egyéb apróbb újítások

A bal és a jobb oldal

A kontrollmérőpontok mérése során a kép melletti táblázatban már egyidejűleg jelennek meg a bal és a jobb oldal mérési eredményei, ezzel lehetővé téve a mérés közbeni összehasonlítást. Az egyes cellákban a maximumértéket per jel választja el a mutatóeséstől.

	Jobb	Bal
1	51/0	51/1
2	64/13	63/12
3	51/0	51/0
4	51/0	51/1
5	64/13	66/14
6	51/0	51/0
7	51/0	51/0
8	51/0	14/6
9	51/0	51/0
10	51/0	51/0

Maximumértékek a táblázatban

A kontollmérőpontok maximumérték szerinti színes táblázatos kiértékelésében mostantól lehetőség nyílik a mért maximumértékek és mutatóesések megjelenítésére is a cellákban. Ehhez mindössze a kiértékelő ablak alsó részén található jelölőnégyzetet kell kipipálnunk.

Kontroll mérőpont

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Kéz		Láb	
Bal	Jobb	Bal	Jobb
Nyirok (51/1)	Nyirok (51/0)	Lép	Hasnyálmirigy
Tüdő (63/12)	Tüdő (64/13)	Máj	Máj
Vastagbél (51/0)	Vastagbél (51/0)	Izületi degeneráció	Izületi degeneráció
Ideg degen. (51/1)	Ideg degen. (51/0)	Gyomor	Gyomor
Keringés (66/14)	Keringés (64/13)	Kötőszövet degen.	Kötőszövet degen.
Allergia (51/0)	Allergia (51/0)	Bőr	Bőr
Szerv degen. (51/0)	Szerv degen. (51/0)	Zsíros degen.	Zsíros degen.
Hármas melegítő (14/5)	Hármas melegítő (51/0)	Epehólyag	Epehólyag
Szív (51/0)	Szív (51/0)	Vese	Vese
Vékonybél (51/0)	Vékonybél (51/0)	Hólyag	Hólyag

Betegség	Súlyozás
Ideális norma	0

Mért értékek mutatása a táblázatban

Mutatóesés
Maximumérték
Súlyozás

OK
Nyomtatás
<
>

Nyirok (51/1)

Saját logó a nyomtatási képen

Az új programverzió lehetőséget nyújt arra is, hogy a nyomtatási kép fejlécében saját elérhetőségünket jelenítsük meg. A nyomtatási kép további újdonsága a kontroll mérés időpontjának fenntartott hely, valamint a sorvezető vonalak:

Report Preview

File Page Zoom

Page 1 of 1 Zoom 100.0 %

EAV
Volt Elektroakupunktúra

Dr. Kovács Lázár
házi orvos
+36-1-123-4567

Név: Ackermann Zoltán
Született: 1973-05-05
Vérnyomás:
Betegség:

Mérés időpontja: 2011.04.03. 10:59:00

Kontrollmérés			
Mérési pont	Max	ME	Min
Nyirok (JK)	51 Norma	0	51
Tüdő (JK)	64 Norma	13	51
Vastagbél (JK)	51 Norma	0	51
Ideg degen. (JK)	51 Norma	0	51
Keringés (JK)	64 Norma	13	51
Allergia (JK)	51 Norma	0	51
Szerv degen. (JK)	51 Norma	0	51
Hármas melegítő (JK)	51 Norma	0	51
Szív (JK)	51 Norma	0	51
Vékonybél (JK)	51 Norma	0	51
Nyirok (BK)	51 Norma	1	50
Tüdő (BK)	63 Norma	12	51
Vastagbél (BK)	51 Norma	0	51
Ideg degen. (BK)	51 Norma	1	50
Keringés (BK)	66 P.E.	14	52
Allergia (BK)	51 Norma	0	51
Szerv degen. (BK)	51 Norma	0	51
Hármas melegítő (BK)	14 S.Deg.	6	8
Szív (BK)	51 Norma	0	51
Vékonybél (BK)	51 Norma	0	51

Deg. - Degeneráció E.Deg. - Enyhe Degeneráció S.Deg.-Súlyos Degeneráció
Gy. - Gyulladás E.Gy.- Enyhe Gyulladás S.Gy.-Súlyos Gyulladás
P.Z. - Primer Zavar S.P.Z. - Súlyos Primer Zavar
Sec.Z. - Secundár Zavar
P.Z. - Patológia Előtti állapot

Kontrollmérés időpontja: _____ mérést végezte